



# คู่มือการใช้งานระบบค้นหาครุภัณฑ์

## 1 หน้าหลัก

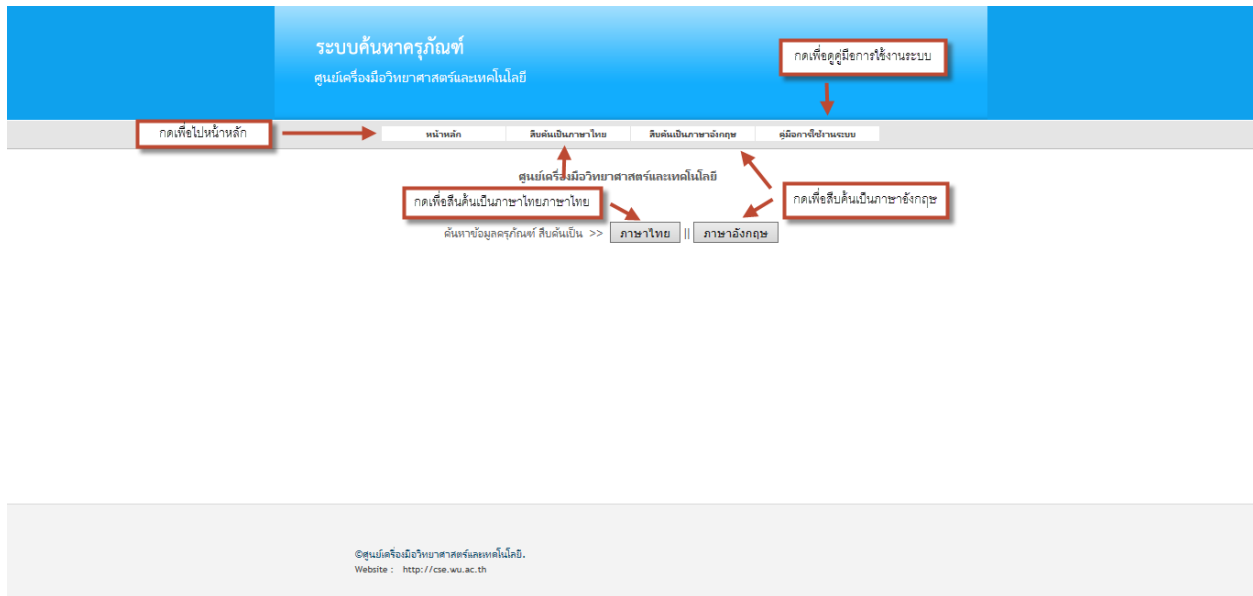

## 2 การสืบค้นเป็นภาษาไทย

หมายเหตุ : เมื่อกดปุ่มค้นหาแล้วอาจจะต้องใช้เวลารอพอสมควรเนื่องจากข้อมูลครุภัณฑ์มีเยอะให้รอจนกว่าระบบจะแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ที่ค้นหา

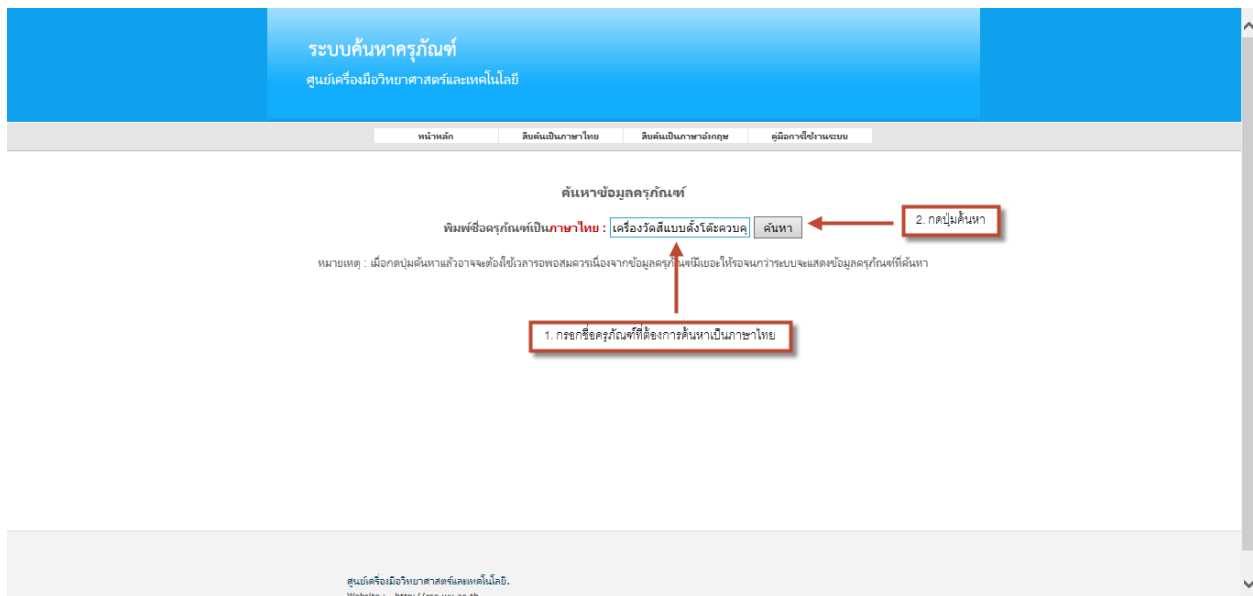

ระบบค้นหาครุภัณฑ์  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของครุภัณฑ์ที่ค้นหาขึ้นมา

หน้าหลัก    ติดต่อเป็นภาษาไทย    ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ    คู่มือการใช้งานระบบ

ค้นหา >> เครื่องวัดสีแบบสัมผัสควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

ชื่อครุภัณฑ์	มีห้อง	รุ่น	Serial No.	Barcode	ห้อง	อาคาร	ผู้ดูแลครุภัณฑ์
เครื่องวัดสีแบบสัมผัสควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์	HunterLab	CX 1595		0000078857	ห้องทำงานพนักงาน 119	B3-อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3	จรรยาพร พิรัมย์ไชยส์

TEL : 3950 E-MAIL : jaruwan@wu.ac.th

เมื่อเข้ามาไปที่ชื่อผู้ดูแลครุภัณฑ์ระบบจะแสดงเบอร์โทรและอีเมลที่ใช้ในการติดต่อผู้ดูแลครุภัณฑ์ขึ้นมา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
Website : http://cse.wu.ac.th

### 3 การสืบค้นเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : เมื่อกดปุ่มค้นหาแล้วอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากข้อมูลครุภัณฑ์มีเยอะให้รอกันกว่าระบบจะแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ที่ค้นหา

ระบบค้นหาครุภัณฑ์  
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้าหลัก    ติดต่อเป็นภาษาไทย    ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ    คู่มือการใช้งานระบบ

ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์

พิมพ์ชื่อครุภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ : pH meter    ค้นหา

หมายเหตุ : เมื่อกดปุ่มค้นหาแล้วอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากข้อมูลครุภัณฑ์มีเยอะให้รอกันกว่าระบบจะแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ที่ค้นหา

1. กรอกชื่อครุภัณฑ์ที่ต้องการค้นหาเป็นภาษาอังกฤษ

2. กดปุ่มค้นหา

©ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
Website : http://cse.wu.ac.th

## ระบบค้นหาครุภัณฑ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของครุภัณฑ์ที่ค้นหาขึ้นมา

หน้าหลัก

สืบค้นเป็นภาษาไทย

สืบค้นเป็นภาษาอังกฤษ

คู่มือการใช้งานระบบ

ค้นหา >> pH meter

ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ	รุ่น	Serial No.	Barcode	ห้อง	อาคาร	ผู้ดูแลครุภัณฑ์
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)	ORION	420A	25111	3020002141	ห้องปฏิบัติการเคมี 8 222	B7-อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7	กัญฉวี วัชรวิเศษ
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)	WTW	PH330I	03200058	0000054366	ไม่ระบุ	โรงพยาบาลศิริราชใหม่	ศศิธร เพ็ญศรี
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)	WTW	PH330I	03200061	0000054367	ไม่ระบุ	โรงพยาบาลศิริราชใหม่	ศศิธร เพ็ญศรี
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง pH meter ชนิดพกพา	Schott	HANDYLAB PH 11	285202999	3020070771	ห้องทดลองสำหรับงานวิจัย 2 205	B3-อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3	ราตรี นิตยเดชพัฒน์
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH meter (แอนน์)	Thermo	ORION 2 STAR	018777	0000094642	ห้องวิจัยทางการแพทย์ 1 130	B6-อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6	TEL : 3693 E-MAIL : sratree@wu.ac.th sratree@wu.ac.th
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH meter	Thermo	ORION 2 STAR	B04960	0000094644	ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 120	B8-อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8	วิรัชดา ภาพิสิทธิ์
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH meter	Thermo	ORION 2 STAR	018774	0000094645	ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 120	B8-อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8	วิรัชดา ภาพิสิทธิ์
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH meter-potefio meter (เกกซ์ซา)	Thermo	ORION 4 STAR	B07236	0000094656	คลังพัสดุ 162		เมื่อขี้น่าสืบที่ข้อมูลครุภัณฑ์ระบบจะแสดงเบอร์โทรและอีเมลที่ใช้ในการติดต่อผู้ดูแลครุภัณฑ์ขึ้นมา
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH meter	Thermo	ORION 2-STAR	020432	0000095568	ห้องทำงานพนักงาน 119	B3-อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3	จรรยาพร พันธุ์ปภัสร์
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH meter	Thermo	ORION 2-STAR	B00653	0000095570	ห้องทำงานพนักงาน 119	B3-อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3	จรรยาพร พันธุ์ปภัสร์
เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง pH meter	Sartorius	DOCU PH	26153038	0000113898	ห้องวิศวกรรมกระบวนการ	B2-อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2	ณิธิสร ชุติ
เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง pH	Sartorius	DOCU PH	26153037	0000113899	ห้องวิศวกรรมกระบวนการ	P2-อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2	ณิธิสร ชุติ